

Общество с ограниченной ответственностью «Лазер-МТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малава С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Областное государственное учреждение здравоохранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кучарова В.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по диагностике, подготовке и периодическому инструментальному метрологическому контролю выходных параметров (далее по тексту – ДПК) изделий лазерной техники (далее по тексту – ИЛТ), перечисленных в Приложении 2 к настоящему договору, который может быть изменен соглашением сторон в связи с приобретением или списанием ИЛТ.

1. Общие положения

1.1. На ДПК принимаются исправные, укомплектованные, в том числе эксплуатационной документацией, ИЛТ.

1.2. ДПК состоит из:

Диагностики общего состояния и функционирования основных узлов ИЛТ и всего изделия в целом, определения его работоспособности и определения необходимости текущего или сложного ремонта.

Подготовки и метрологического контроля, который производится на соответствие основных технических характеристик эксплуатационной документации один раз в год, а также после проведения текущего ремонта, если этот ремонт проводился на основных функциональных узлах ИЛТ и мог повлечь за собой изменение технических характеристик.

1.3. В состав работ по ДПК ИЛТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроаппаратуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИЛТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИЛТ.

1.4. Ответственность за эксплуатацию ИЛТ, на которые Заказчику Исполнителем выдано Извещение о несоответствии выходных параметров паспортным данным, несет Заказчик.

1.5. При необходимости выполнения сложного ремонта (по направлению специалиста Исполнителя) ИЛТ должно быть доставлено на предприятие Исполнителя транспортом Заказчика. Сложный текущий ремонт оплачивается Заказчиком по отдельному счету или счет-фактуре исходя из фактических затрат.

1.6. По результатам работы Заказчику выдается АКТ о метрологическом инструментальном контроле, либо ИЗВЕЩЕНИЕ о несоответствии (от ИЦСМ).



2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить один раз в 12 месяцев диагностику ИЛТ и инструментальный метрологический контроль соответствия основных технических характеристик ИЛТ паспортным данным с выдачей соответствующего документа от ФБУ «Иркутский ЦСМ». Внеочередная проверка основных технических характеристик ИЛТ обеспечивается после текущего ремонта, если этот ремонт проводился на функциональных узлах и блоках ИЛТ и мог повлиять на выходные параметры.

2.1.2. Проводить один раз в год инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации ИЛТ, принятых на ДПК, а при получении нового ИЛТ – проводить внеочередной инструктаж.

2.2. Исполнитель имеет право:

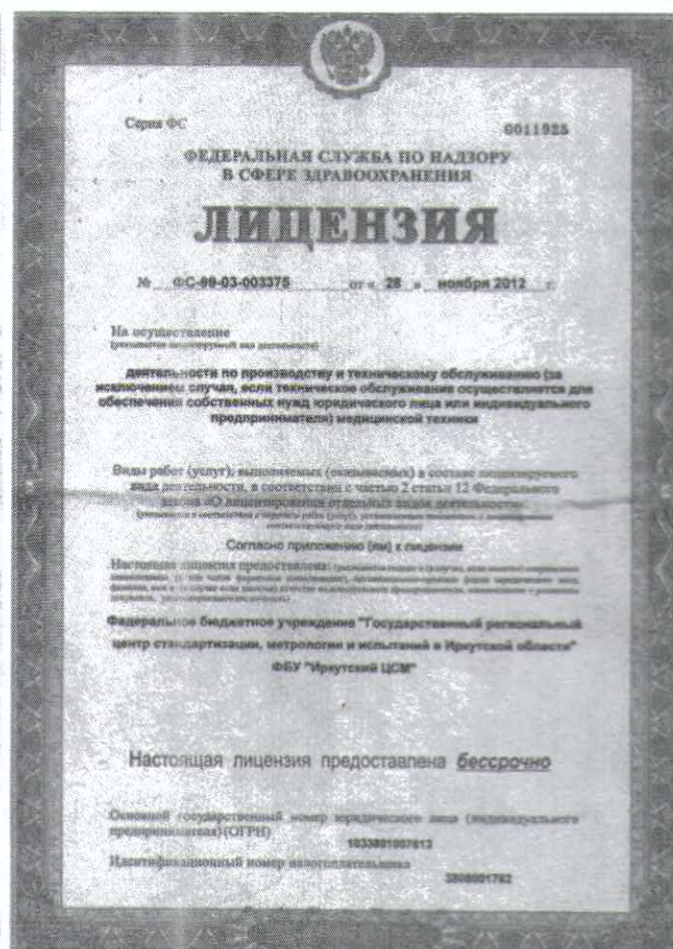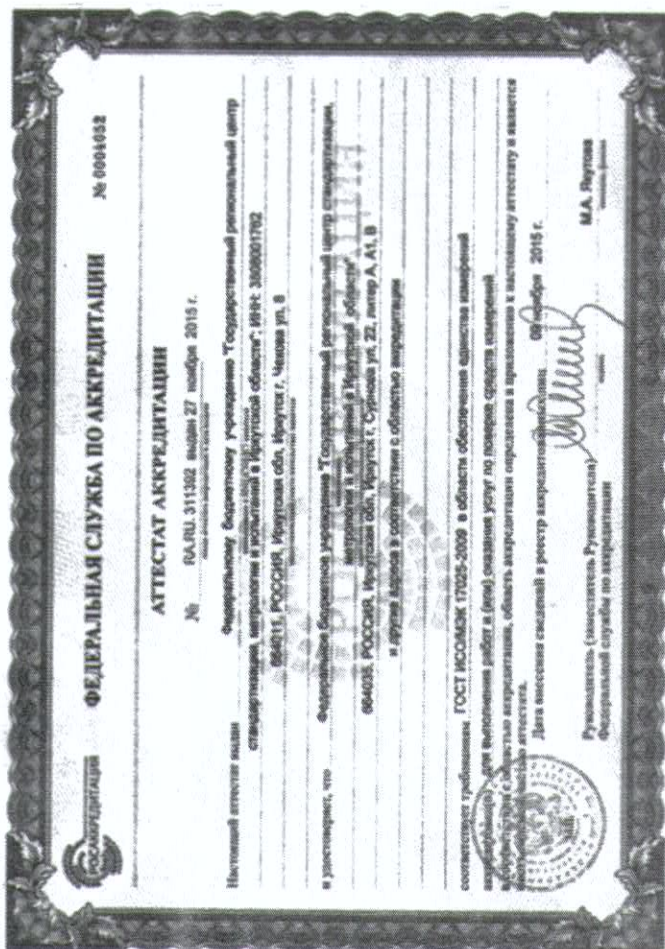

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

(при необходимости)

№ п/п	Должность	Подпись	ФИО
1.	Начальник отдела муниципальных заказов		
2.	Главный бухгалтер Заказчика		
3.	Руководитель Заказчика		
4.	Юрист департамента здравоохранения		
5.	Начальник департамента здравоохранения		
6.	Начальник отдела цен администрации г. Иркутска		
7.	Начальник управления здравоохранения по финансово-экономическим вопросам		

Приложение №1 к Договору № 12-16

СМЕТА

расходов по диагностике, подготовке и периодическому метрологическому инструментальному контролю выходных параметров одного изделия лазерной техники (ИЛТ), (без НДС). Согласовано с Отделом тарифного регулирования Администрации г.Иркутска, 01.07.2013 г., № 132-74-17/13				
№ п/п	Наименование статьи расходов	Единицы измерения	Сумма, руб.	
1	Трудоёмкость работ по диагностике и подготовке к метрологическому контролю выходных параметров одного ИЛТ	чел/час	3	
2	Оплата труда основного персонала	руб.	300,00	
3	Начисления на фонд оплаты труда (26% от п.2)	руб.	78,00	
4	Накладные расходы (оплата труда АУП и АХП, коммунальные расходы, амортизация оборудования, транспортные расходы и т.п.)	руб.	130,00	
5	Госповерка измерителя лазерного излучения ИМО-2Н	руб.	200,00	
5	Итого себестоимость	руб.	708,00	
8	Метрологический Контроль выходных параметров на базе ИЦСМ	руб.	500,00	
	ИТОГО расходов на обеспечение диагностики, подготовке и метрологическому контролю выходных параметров одного ИЛТ		1 208,00 руб.	

Директор ООО «Лазер-МТ»

С.Н.Магов

Приложение №2 к Договору № 12-16

ПЕРЕЧЕНЬ изделий лазерной техники Заказчика

1. Аппарат лазерный физиотерапевтический «УЗОР-А-2К»

Руководитель Заказчика

Кучаров В.Б.

М.П.

2.2.1. Отказаться от принятия на ДПК ИЛТ, эксплуатация которых осуществляется Заказчиком с нарушением требований нормативных документов по обеспечению техники безопасности.

2.3. Заказчик обязуется:

- 2.3.1. Своевременно оплачивать выполненные Исполнителем работы.
- 2.3.2. Обеспечить правильную эксплуатацию и использование ИЛТ, принятой Исполнителем на ДПК, не допускать к работе на этой аппаратуре лиц, не прошедших специальную подготовку.
- 2.3.3. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности в цехах, отделениях и кабинетах при работе персонала с ИЛТ.
- 2.3.4. Обеспечить сохранность штатных запасных частей и материалов, поступивших в комплекте с ИЛТ.

2.4. Заказчик имеет право:

- 2.4.1. Проверять объемы и качество работ по ДПК ИЛТ.
- 2.4.2. Совместно с представителями Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов из штатного комплекта ИЛТ при проведении текущего ремонта.

3. Порядок расчетов

- 3.1. Настоящий Договор является основанием для расчетов между сторонами.
- 3.2. Стоимость работ по ДПК составляет 1 208,00 руб. без НДС по состоянию на 01.07.2013 г. за одну единицу ИЛТ в год (Приложение 1) и может корректироваться не чаще одного раза в квартал при изменении тарифов ООО «Лазер-МТ» или ИЦСМ.
- 3.3. Стоимость работ по ДПК по настоящему договору составляет 1 208 руб. без НДС за одну единицу ИЛТ (Приложение 2).
- 3.4. В качестве одного из критериев изменения стоимости услуг Исполнителя используется индекс-дефляторы по отраслям экономики, рассчитанные Минэкономразвития России.
- 3.5. Основанием для оплаты за производимые работы ДПК ИЛТ является Акт приемки-сдачи выполненных работ.
- 3.6. Ежеквартально производится сверка взаиморасчетов, для чего полномочный представитель Заказчика выезжает в адрес Исполнителя.

4. Срок действия договора и юридические адреса сторон

- 4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания по 31.12.2016 г.
- 4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в судебном порядке по заявлению одной из сторон в случае неисполнения условий Договора другой стороной.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Лазер-МТ»

ИНН / КПП 3812070173 / 381101001

Почтовый адрес: 664033 г.Иркутск, а/я 390

Юридический адрес: 664033 г.Иркутск,

ул.Пермонта 287-5

т/ф (3952), 51-14-36, т. 754-032 р/с 4070 2810 5040

0003 1701 в Сибирском филиале ПАО

«Промсвязьбанк» г.Новосибирск к/с 3010 1810

5000 0000 0816

БИК 0450004816

Директор ООО «Лазер-МТ» к.ф.-м.н.

С.Н.Магов

М.П.

Приложение 1. Смета расходов по ДПК одного ИЛТ.

Приложение 2. Перечень изделий лазерной техники Заказчика

Приложение 3. Аттестат аккредитации и Лицензия ФБУ «Иркутский ЦСМ»

ЗАКАЗЧИК

Областное государственное автономное

учреждение здравоохранения «Усольская

городская стоматологическая поликлиника»

ИНН/КПП 3819004420/385101001

Адрес: 665463, г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина,

15. Тел/факс 8 (39543) 3-91-43, л/сч 80701010150

Минфин Иркутской области (ОГАОУЗ «Усольская

городская стоматологическая поликлиника» л/с

80303090130)

р/с 40601810500003000002 в ГРКЦ ГУ Банка

России,

БИК 042502000,

Кучаров В.Б.

М.П.

Гл.врач